
POW
off
EPILDREAM ONE
DIODE LASER



CON IL LASER A DIODO EPILDREAM TI DIMENTICHI DEI PELI SUPERFLUI IN UN SOFFIO.

EPILDREAM la più grande innovazione tecnologica per l'epilazione progressiva permanente. **Più Veloce, Più Sicuro, Più Performante.**

EPILDREAM DIODE LASER

APG TECH

La Bellezza in buone mani.

ALFAPARF GROUP

www.alfaparfgroup.it

EPILDREAM ONE
DIODE LASER

CRGO

VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA

CEI 62-5

2021 [illegible] 03

- SCAD.

2024 LUGLIO

[illegible] SCAD.

VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA
CEI 62-5
Apparecchiatura N° 13

2022 - SCAD.	2024 - SCAD.
	LUGLIO
2028 - SCAD.	2030 - SCAD.
SETEMBRE	

VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA
CEI 62-5
Apparecchiatura N° 13

2020 - SCAD.	2022 - SCAD.	2024 - SCAD.
28/05/2022	20/07	LUGLIO
2026 - SCAD.	**2028 - SCAD.**	**2030 - SCAD.**
SETEMBRE		

VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA
CEI 62-5
Apparecchiatura N° 13

2020 - SCAD.	2022 - SCAD.	2024 - SCAD.
28/05-2022	20/07	LUGLIO
2026 - SCAD.	**2028 - SCAD.**	**2030 - SCAD.**
SETEMBRE		

Energia 40 J cm²
Durata impulso 300 ms
Lunghezza D'onda 808 nm

DISTRIBUITO DA
BEAUTY & BUSINESS S.p.A.
(MILANO - ITALY)

Model: Epildream One

Serial: EO - 0150

Input 220-240 Vac 50/60 Hz 1800 VA

DIRETTA O DIFFUSA
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 4
Max Energia 40 J cm²
Durata impulso 300 ms
Lunghezza D'onda 808 nm

DISTRIBUITO DA
BEAUTY & BUSINESS S.p.A.
(MILANO - ITALY)

Model: Epildream One

Serial: E0 - 0150

Input 220-240 Vac 50/60 Hz 1800 VA

EO150

EO150








LINAK




ON
OFF
HEAT
CONTROL


UN1170

STERILIZER
Model:WN308A
Power:100W
Voltage:220-240V ~ 50/60Hz
MADE IN CHINA

GTS GROUP S.p.A.
Torre Boldone - BG - Italy

SCALDAFANGO	COD. 1090024
230 - 240 V~	FREQUENZA 50 Hz
POTENZA 100 W	TEMP MAX 50° C
⚠ CLASSE I	CE



MOSER
CHROMINI
PRO
MOSER
facelook
New Edition
SONAR
REMINGTON

È QUALIFICATO ALL'USO
DELLA MULTITECNOLOGIA
DIBISKIN MANAGER

www.rheacosmetics.com


Tenderly
Comfort
DECODERM


@PL
650/8.3

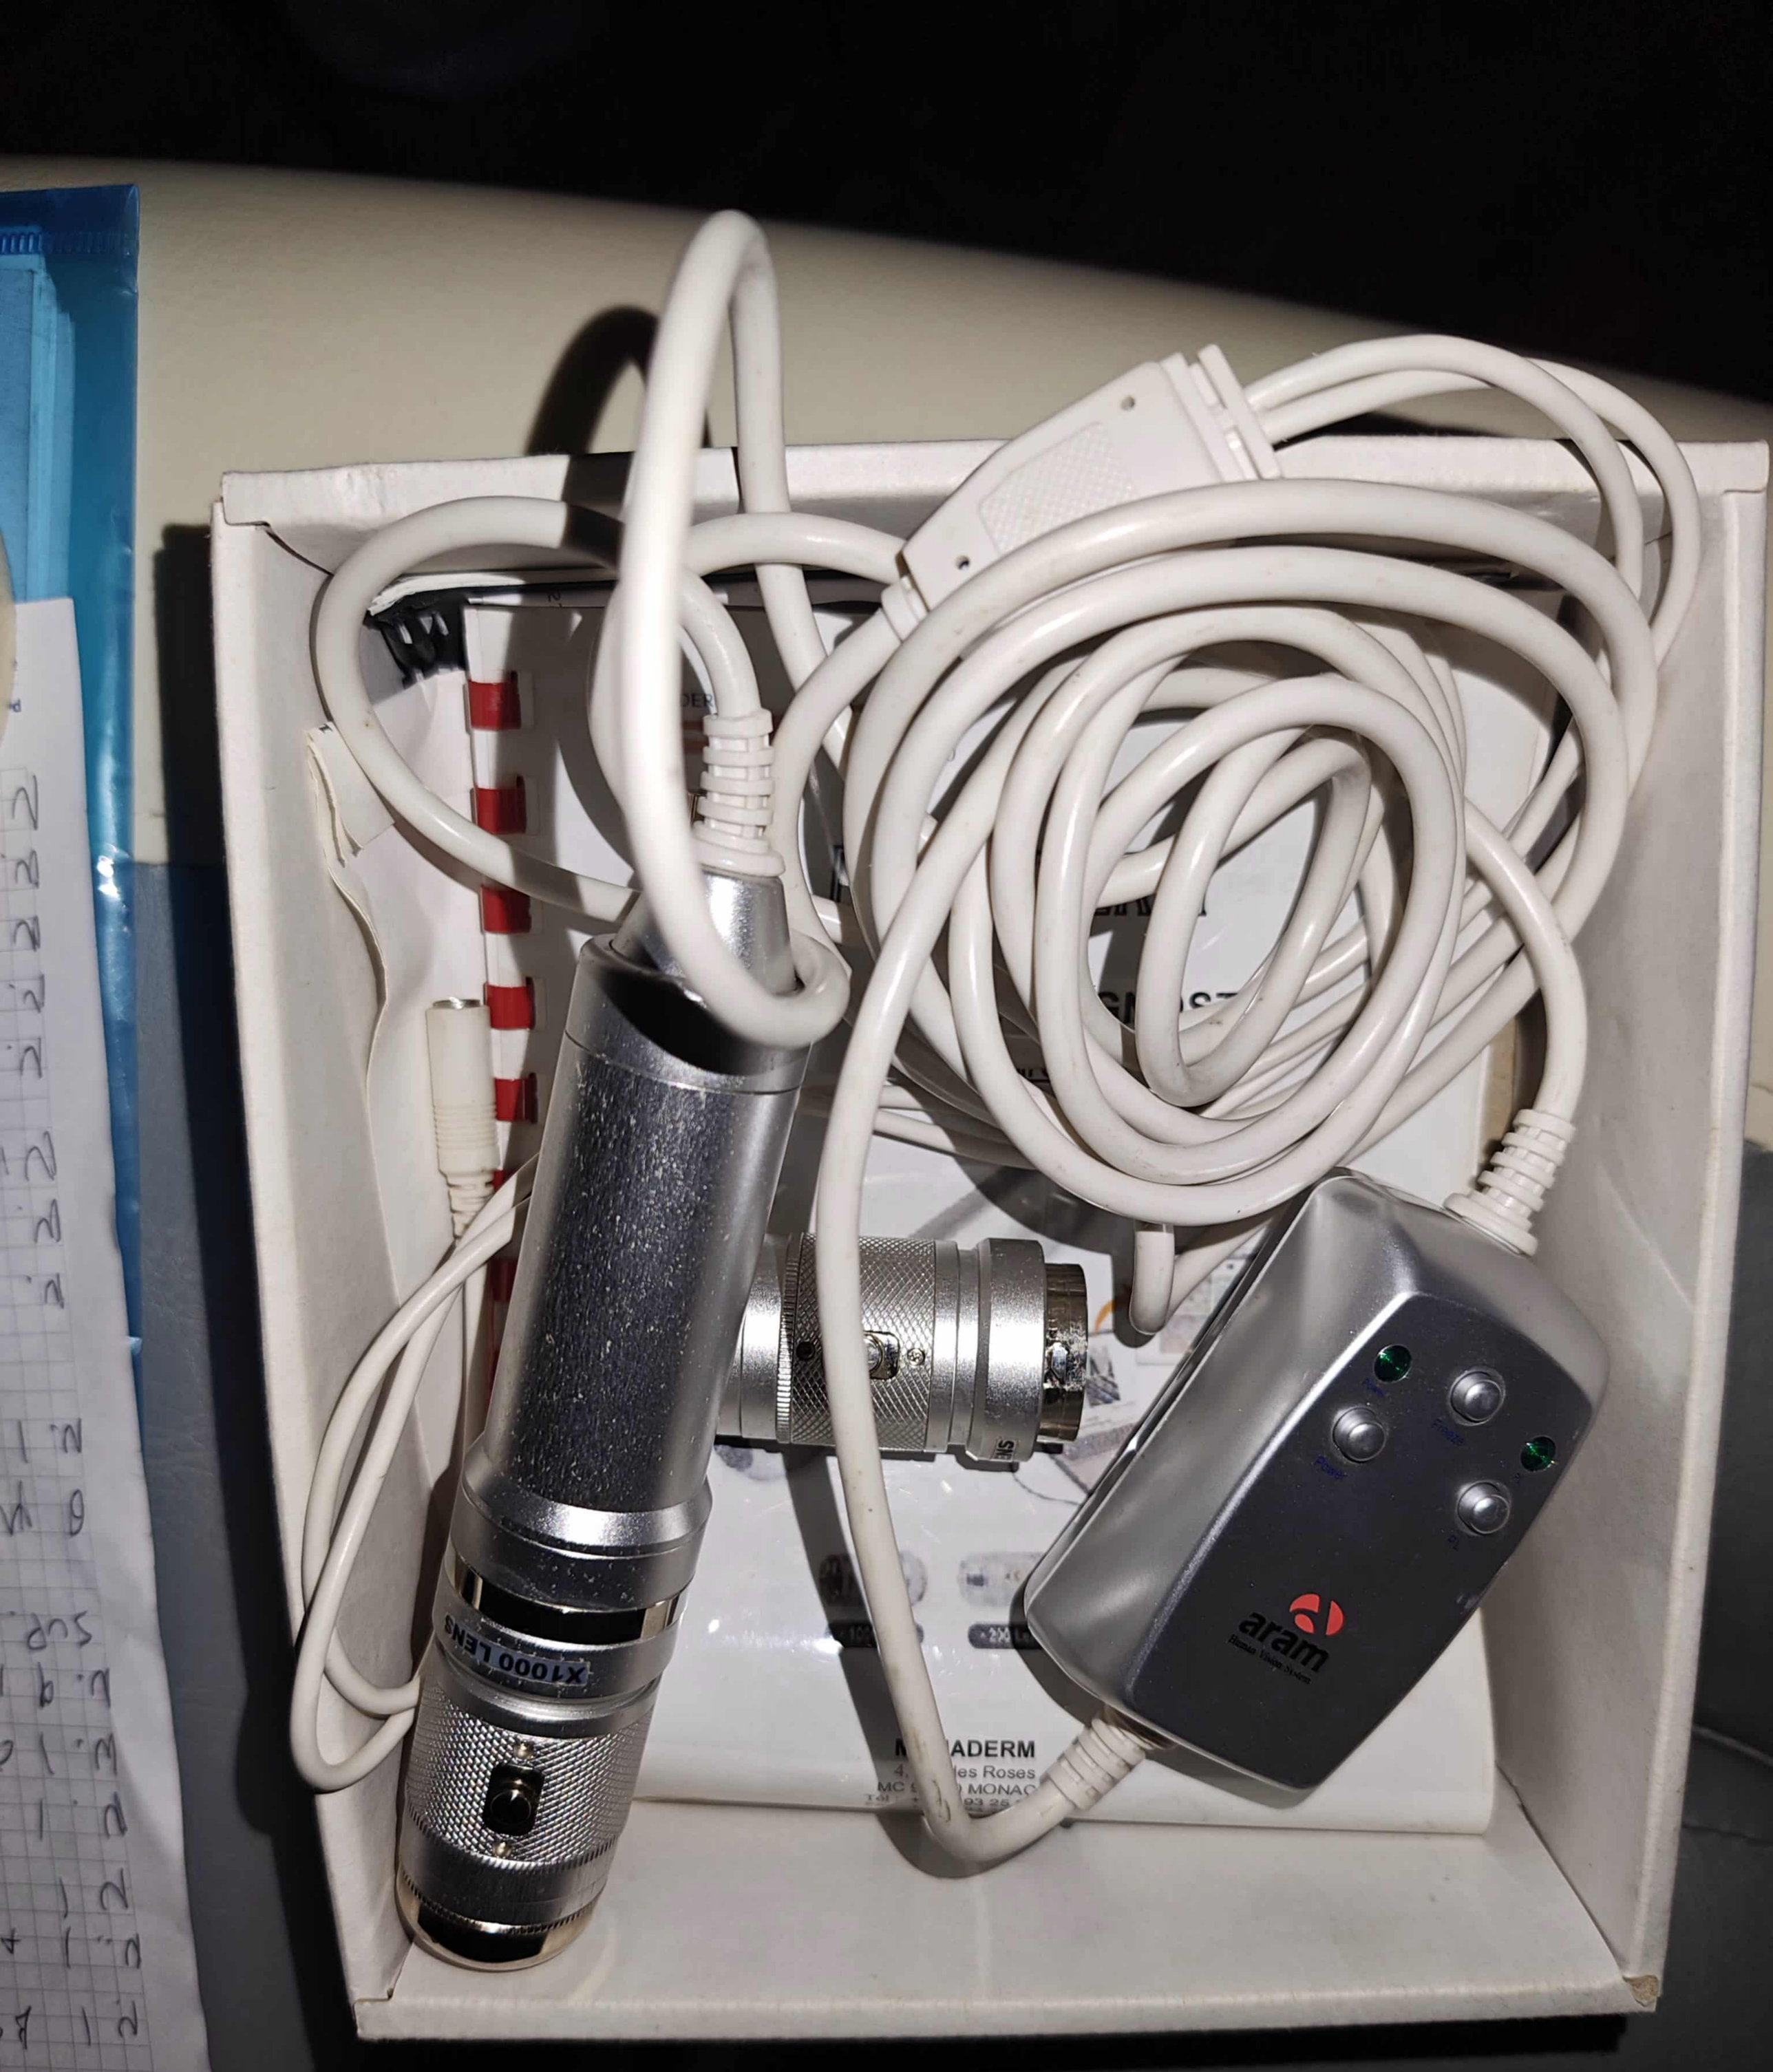
X1000 LENS
aram


UK
CA
R-NZ

DSN: G0922H0624020675

ASSEMBLED IN CHINA

201-220208

D 22 0054 201

Amazon EU
L-1855
Luxembourg

UK
CA

R-NZ




SILVERCREST







Vitale
HEALTH & BEAUTY SYSTEMS

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

VITALE-EMS



CE

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

È un dispositivo di modellamento del corpo unico nel suo genere e non invasivo, che utilizza l'energia elettromagnetica focalizzata ad alta intensità (HIFEM) per attivare le contrazioni muscolari. In questo modo rafforza i muscoli e allo stesso tempo crea una reazione metabolica per abbattere il grasso. Al momento non esiste un'altra tecnologia che abbia la capacità di affrontare contemporaneamente muscoli e grassi. VITALE-EMS ha due manipoli, che possono essere utilizzati singolarmente o contemporaneamente su addome, glutei, gambe, braccia, spalle ecc.

L'energia ad alta intensità è in grado di penetrare in profondità di 8cm oltre lo strato adiposo.

FUNZIONI PRINCIPALI

Costruzione muscolare

Riduzione del grasso

Modellare il corpo e la linea

Attivazione e rigenerazione del collagene

Tonificare e rassodare il corpo

SPECIFICAZIONI TECNICHE

Nome del prodotto: VITALE-EMS

Modello: MJL-EMS01

Schermo operativo: Ampio touch screen da 8 pollici

Due manipoli standard : (diametro: 135-140 mm)

Intensità della vibrazione magnetica: 7 Tesla

Livello di intensità di uscita : 1-100

Frequenza di uscita: 1-40Hz regolabile

Fusibile :20A

Tensione di ingresso : 220V

Dimensioni della macchina : 48 * 58 * 43 cm

Peso: 42 kg

Costruzione muscolare

Riduzione del grasso

Modellare il corpo e la linea

Attivazione e rigenerazione del collagene

Tonificare e rassodare il corpo

SPECIFICAZIONI TECNICHE

Nome del prodotto: VITALE-EMS

Modello: MJL-EMS01

Schermo operativo: Ampio touch screen da 8 pollici

Due manipoli standard : (diametro: 135-140 mm)

Intensità della vibrazione magnetica: 7 Tesla

Livello di intensità di uscita : 1-100

Frequenza di uscita: 1-40Hz regolabile

Fusibile :20A

Tensione di ingresso : 220V

Dimensioni della macchina : 48 * 58 * 43 cm

Peso: 42 kg

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

È un dispositivo di modellamento del corpo unico nel suo genere e non invasivo, che utilizza l'energia elettromagnetica focalizzata ad alta intensità (HIFEM) per attivare le contrazioni muscolar In questo modo rafforza i muscoli e allo stesso tempo crea una reazione metabolica per abbattere grasso. Al momento non esiste un'altra tecnologia che abbia la capacità di affronta contemporaneamente muscoli e grassi. VITALE-EMS ha due manipoli, che possono essere utilizz singolarmente o contemporaneamente su addome, glutei, gambe, braccia, spalle ecc.

L'energia ad alta intensità è in grado di penetrare in profondità di 8cm oltre lo strato adiposo.

FUNZIONI PRINCIPALI

Costruzione muscolare

Riduzione del grasso

Modellare il corpo e la linea

Attivazione e rigenerazione del collagene

Tonificare e rassodare il corpo


SPECIFICAZIONI TECNICHE

Nome del prodotto: VITALE-EMS

Modello: MJL-EMS01


Schermo ... da 8 pollici

COMPONENTI

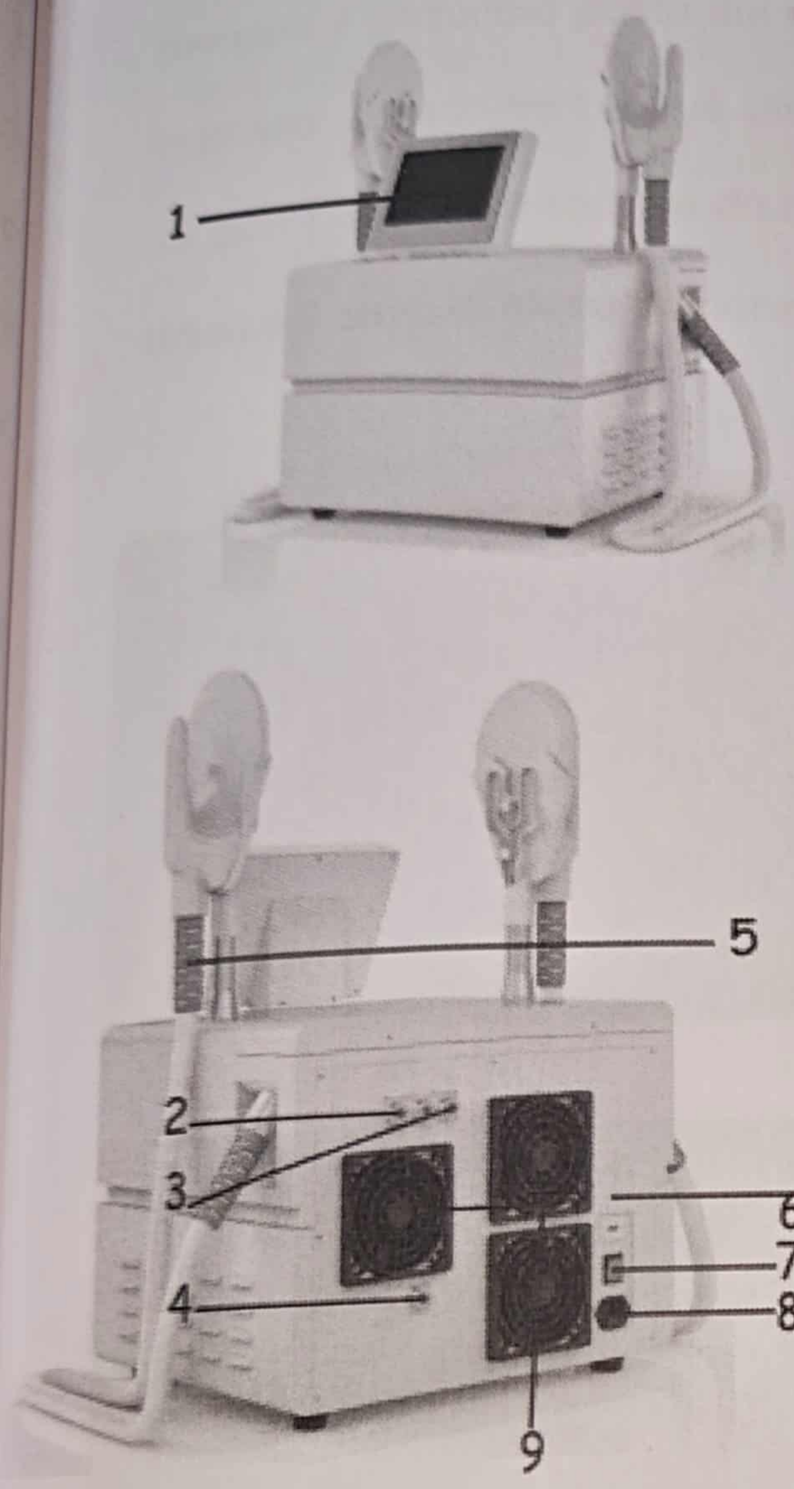


1. display touch screen
2. Ingresso acqua distillata
3. Sovra flusso
4. Uscita acqua distillata
5. Manipoli
6. Ingresso usb
7. Interruttore di accensione
8. presa di alimentazione
9. ventola

ACCESSORI

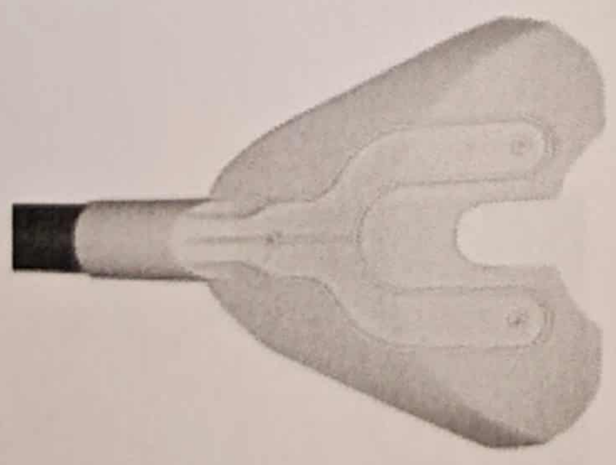

Alloggio manipolo

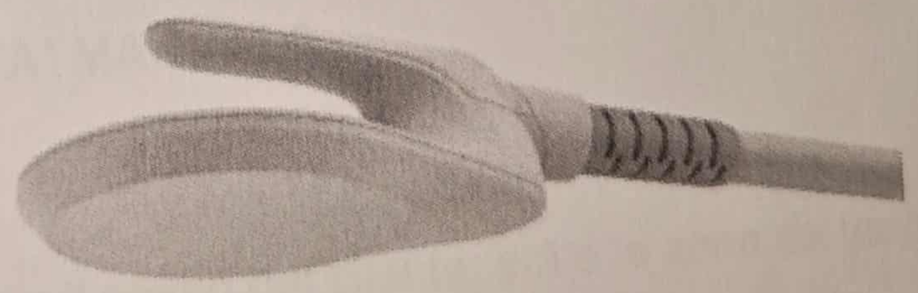

manipolo





DIBI

DIBISKIN RF

DIBISKIN RF

DIBI CENTER

FOUR SEASONS

ON/OFF

CLEANSING

TIMER

START PAUSE

PATTING

PERMEATION

A

B

DIBI CENTER

FOUR SEASONS

ON/OFF

CLEANSING

TIMER

START PAUSE

PATTING

PERMEATION

A

B

DIBI
DIBISKIN
POWER
BODY
FACE
VIBRATION
INTENSITY
START
PAUSE

DIBI

DIBISKIN
POWER

BODY

FACE

VIBRATION

INTENSITY

START
PAUSE

DIBI CENTER

FOUR SEASONS

282

ON/OFF

CLEANSING

TIMER

START PAUSE

PATTING

PERMEATION

A

B

DIBI

DIBISKIN RF

781

DIBIBODY

YES

OUTPUT

JONO

1 2

NO

ULTRASONIC

DIBIBODY

ULTRASONIC

GUIDA AL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

JONO

JONO

Dren Soft
Dren Strong
Cell Soft
Cell Strong
Adipe

DIBI

DIBI

DIBIBODY


ULTRASONIC



DIBI

GUIDA AL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

DIBIBODY
ULTRASONIC

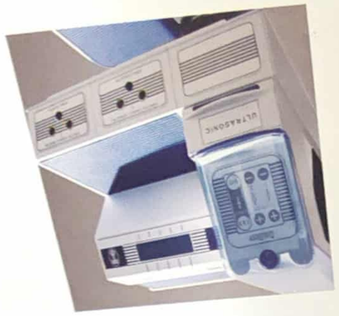

Dren Soft | Dren Strong | Cell Soft | Cell Strong | Adipe

DIBIBODY


ULTRASONIC

riposo e benessere vi
a spegnere i cellulari
ttamenti e ad abbassare
eria in sala d'attesa
Grazie.

CENTRO
StarbenE



Ardes

POLIDEP
by ETOILE

TIMING BOARD

MINUTI

SET

STOP

START

IMPULSE BOARD

DURATA IMPULSI

NUMERO IMPULSI

POWER CONTROL BOARD

INTENSITA'

CONTROLLO EMISSIONE

TECNO'DERME

Per il vost
inviteremo
durante i tr
la suo

POLIDEP

by ETOILE

SET

ETOILE Snc MEDIGLIA (ITALIA)

MATR. 270396A

MOD. 876 SERIE 06

V. 220 - 110 Vac.	Hz : 50-60	VA 80
Fuse : 2 x 20 -	Val. 2 A	Pz. 2
Freq. 1.35 MHz	I max.	

CLASSE I°
TIPO BF

Made in C E E
Dir. 89336

CE


CENTRO
Starbene
NUTRIMENTO DI UN
EGGEREZZA DI UNA
Arrlas
POLIDEP
TIMING BOARD
MINUTI
IMPULSE BOARD
POWER CONTROL BOARD
INTENSITÀ
CONTROLLO EMISSIONE

Ardes

TIMING BOARD

IMPULSE BOARD

DURATA IMPULSI

NUMERO IMPULSI

SLENDER life

EURO

700 Watt

trattamenti e ad abbassare
la suoneria in sala d'attesa
Grazie.



CENTRO
StarbenE

BODY TECH

DIBI

BODY TECH

Benda
Trattamento Corpo

Body Treatment Wraps

Contiene 10 bende imbibite con 230 ml e 7,78 fl.oz.
Contains 10 wraps soaked in 230 ml e 7,78 fl.oz.









VAPOR

ON

OFF

OZONE

ON

OFF









SWISS
Towel

HC-6 Mini Cabi


PRO
DIB
SWISS
Towel
HC-6 Mini Cabi






Cellulite molle


LPG®
cellum6® KEYMODULE
VALID
START
STOP
ESCAPE
cellum6® KEYMODULE

cellum6®

KEYMODULE








OFF


farmoqa
RELAX MASSAGE
EMUD massage
OLIO SCORRIM
MASSAGE OIL
con Vitamina E
with Vitamin E
OFF
HEAT
CONTROL








TOWEL WARMER


TOWEL WARMER


BODY
ACTION 3X3
LIPOLASER + R.F. + ULTRASOUND
mister

BODY
ACTION 3X3
LIPOLASER + R.F. + ULTRASOUND
muster

T-SHOCK
THALASSO
START
STOP


T-SHOCK
THALASSO
START
STOP
6
5
4
3
2
1
0


TERMOESTETICA
farmogal
T-SHOCK
THALASSO



DIBIBODY

DREN

CELL 1 - 2 / CELL 3 - 4

Guida al trattamento professionale

FLEX 1717E090

DIBI

DIBIBODY®

up

down

Start

Stop

Pause

Esc

OK

Check

Reset

Modem

DIBIBODY®

TONIC

HIGH IMPACT 8 – 10 / LOW IMPACT 8 - 10

Guida al trattamento professionale

DIBI

DIBIBODY®

Start

Pause

Check

Modem

Stop

Esc

Reset

OK

up

down

Guida al trattamento professionale

DIBIBODY

LIPO

LYSIS 8 - 10 / COMPACT 8 -10

Guida al trattamento professionale

DIBI

DIBIBODY®

up

down

Stop

Start

Esc


Pause

OK

Reset

Check

Modem

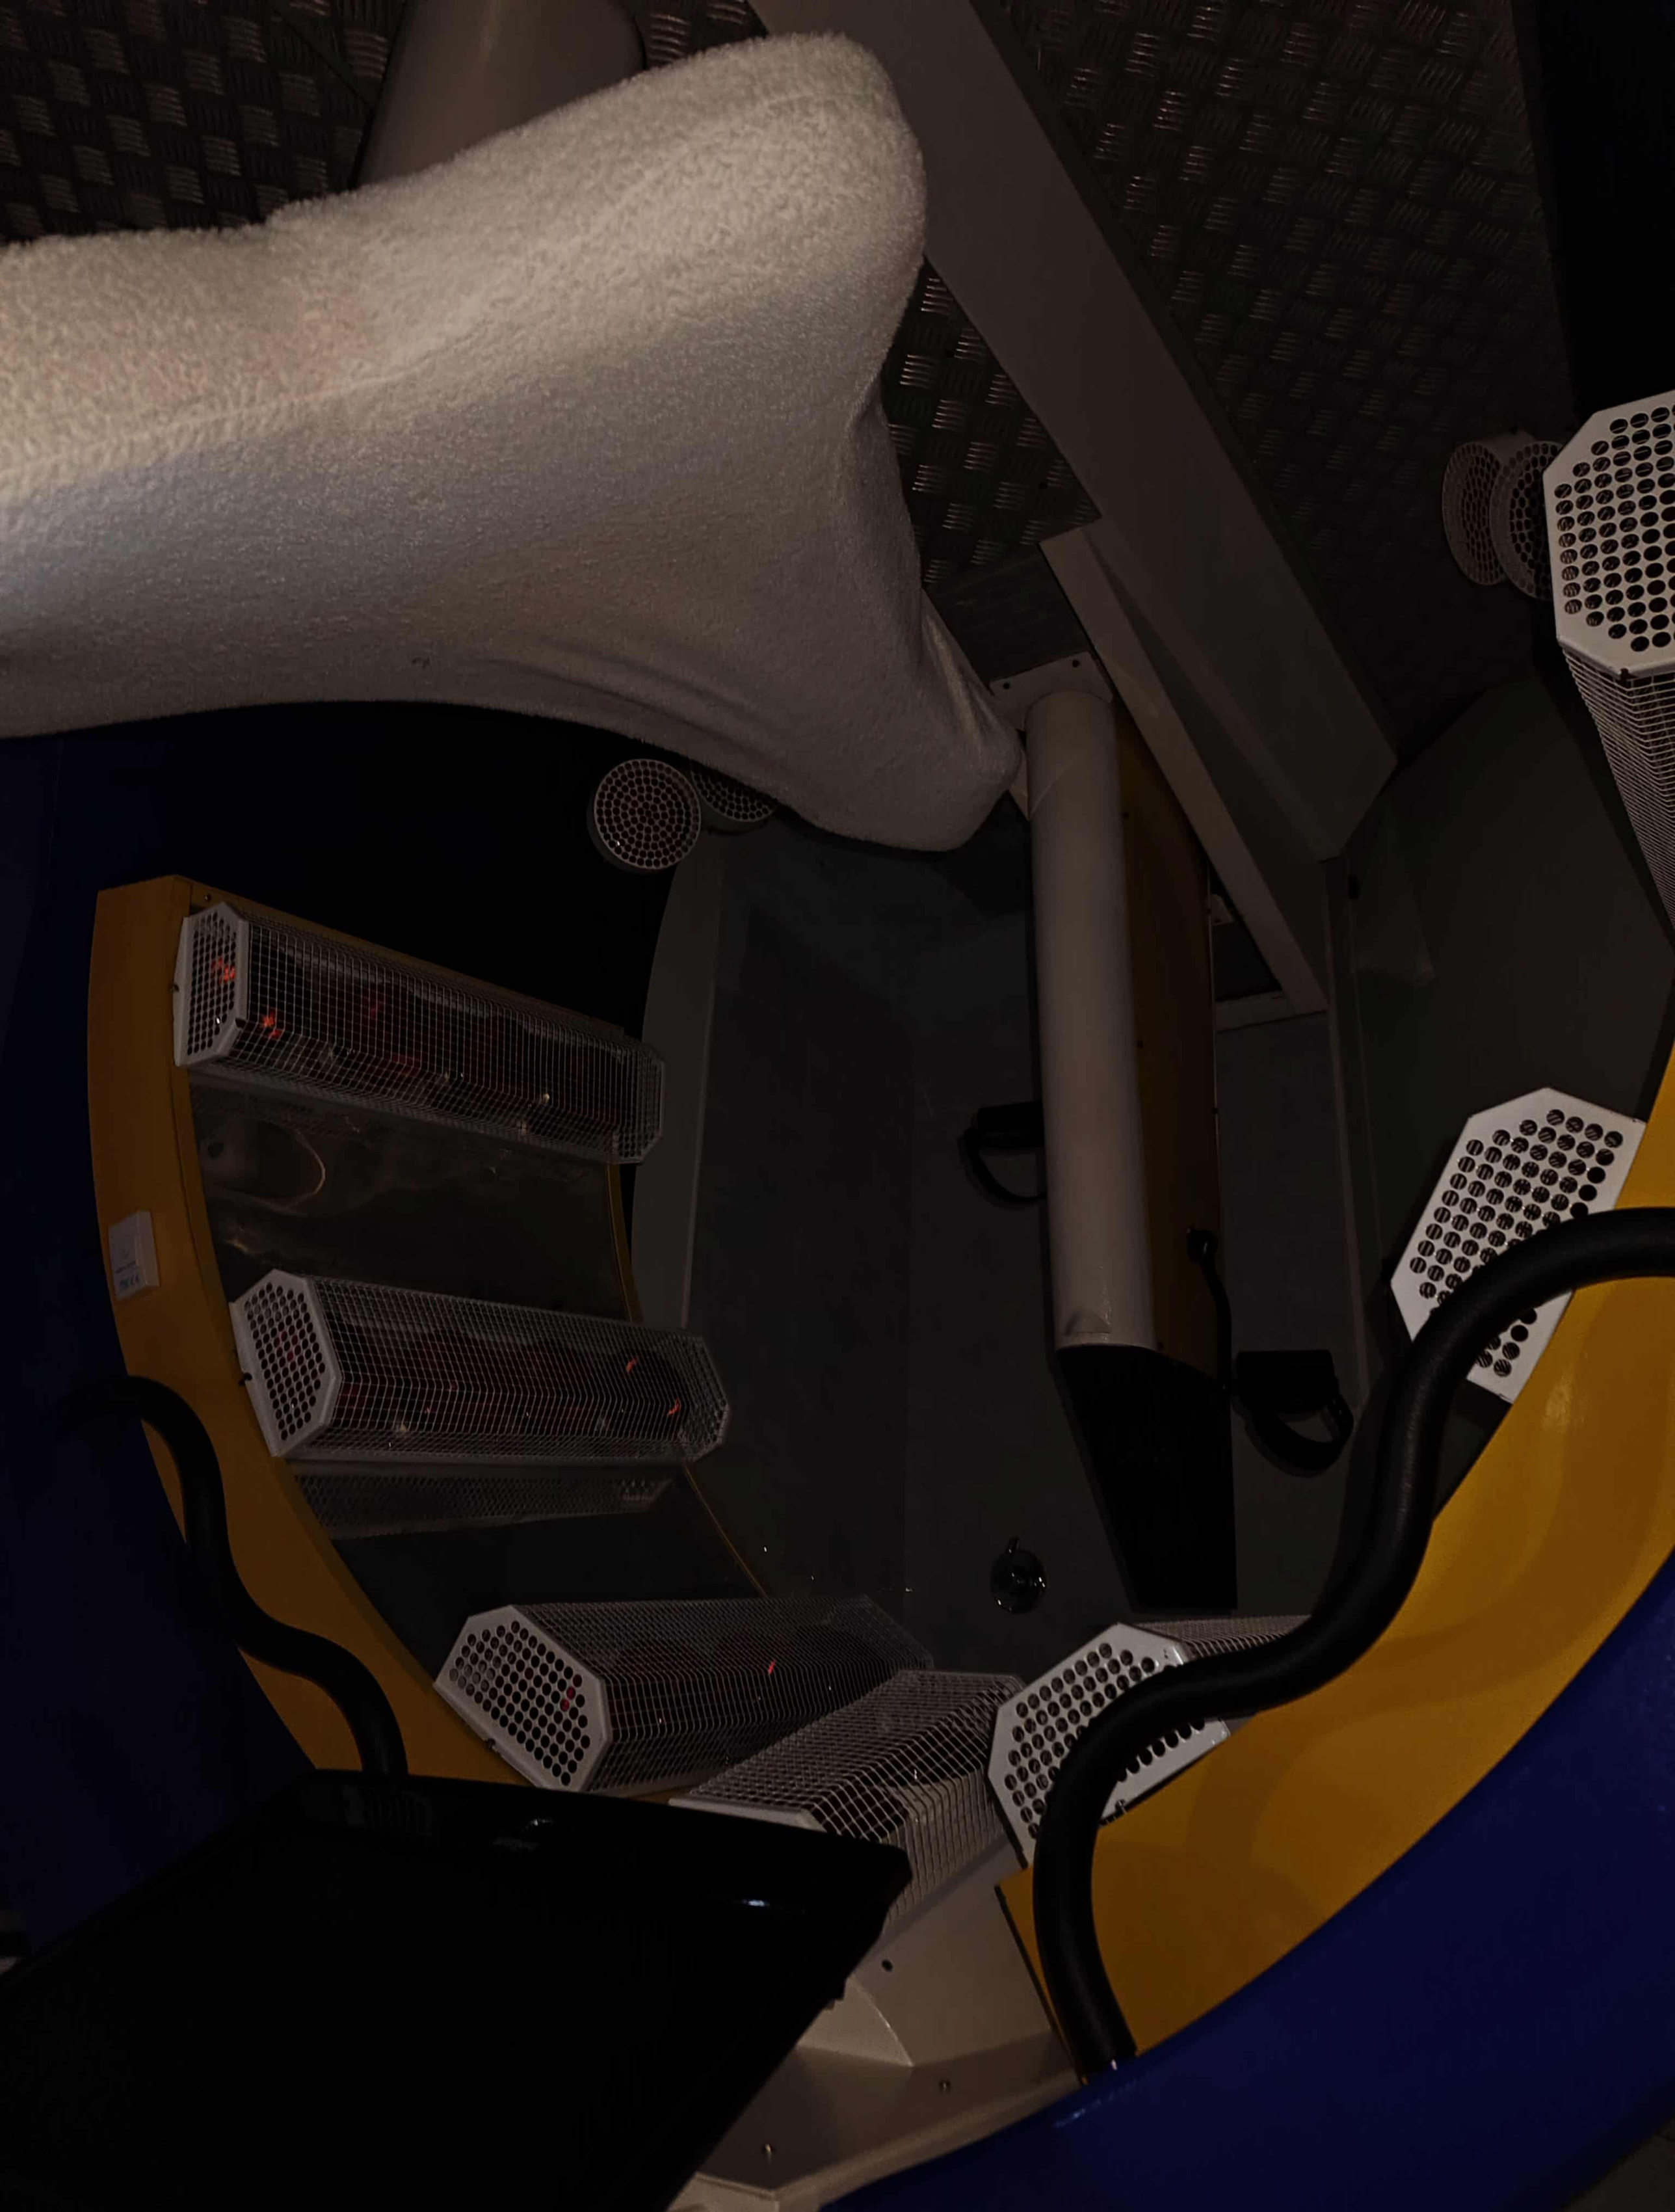









GTS GROUP S.p.A.


TORRE BOLDONE - BG - ITALY

Mod. Infraslim Fit System

Cod. 1180012

400 V~ 3 N 50 Hz 3,5 kW

Serie 1111093

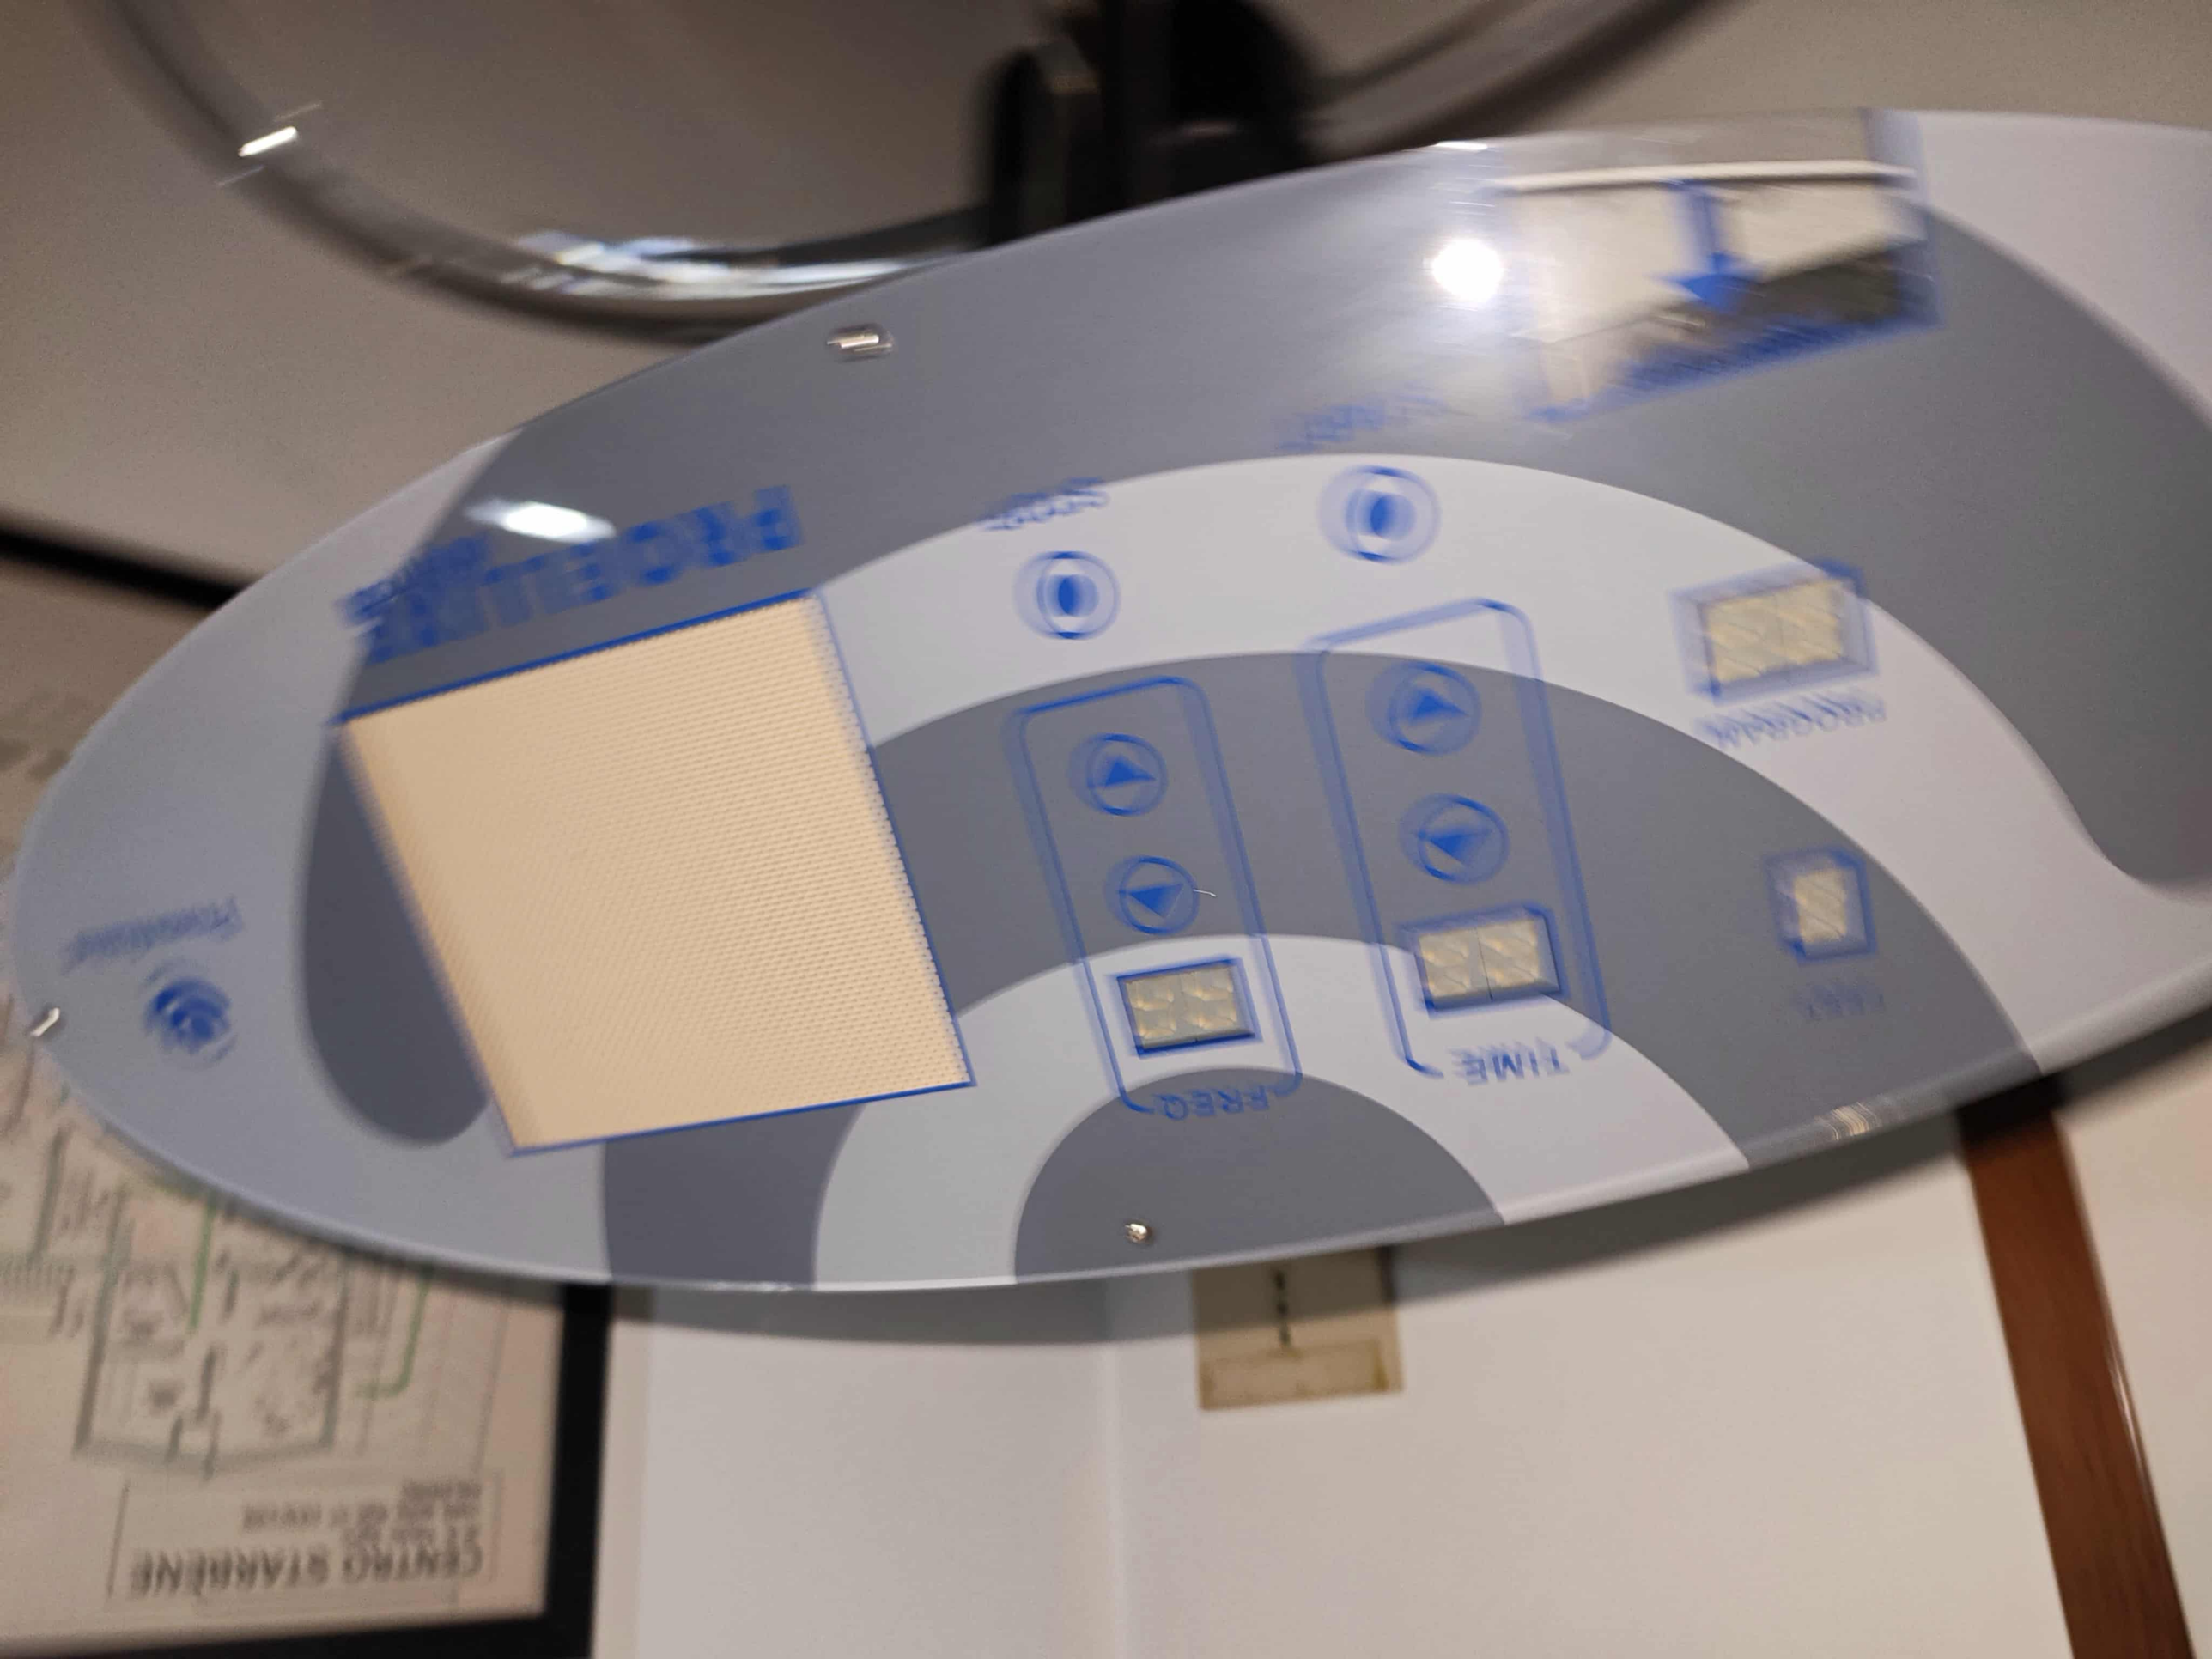
FREQ
TIME




SLIM PRESS 3N7


muster
SLIM
PRESS 3IN1
INFRARED&STIMOL



DIBI HA INVENTATO LA "MACCHINA DEL TEMPO"

Dibitron 2

DIBITRON FACE



LA CURA DI BELLEZZA ANTIRUGHE UNICA AL MONDO

DIBI

SPECIALISTA IN CURE DI BELLEZZA

DIBI HA INVENTATO LA
"MACCHINA DEL TEMPO"

Dibitron

DIBITRON FACE





LA CURA DI BELLEZZA ANTIRUGHE UNICA AL MONDO

DIBI

SPECIALISTA IN CURE DI BELLEZZA

ART. 9145

220-240V ~ 50Hz

250 W MATR. Nr. 4705001

Apparecchio Tipo/Appliance Type: BF

MÜSTER e DIKSON SERVICE S.p.a.

FUSIBILE/FUSE
F5A250V

23

24


CiaoBosi

Linfo Press

KEOS

Enter Pause

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Start

Stop


Linfo Press
KEOS
Enter
Pause
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Start
Stop



PROGRAMME

TIMER

VACUUM-METER IMPULSED

START

STOP

PAUSE

REGULATOR

TRICO LOGICA-µP

VACUUM-METER CONTINUED


seca
kg
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

DIBI
SKIN MANAGER




seca
60
50
40
30
110
120
130
140
kg


EN250-WARNING—DO NOT EXCEED 500 PSI
FLEXIBILITY


SI TECH
LYSEKIL
SWEDEN

PAREDES

ASCIUGAMANI DI OVATTA
IN ROTOLO

CARTONE DA 6 ROTOLI

421320

ESSUIE-MAINS
PAPER TOWELS
TOALLAS


X OUATE
NT TISSUE
OS GUATA
DOTTO IN UE



Setting

188

Heat

Current

188

ON
OFF

Massage Stone Heater

Microcomputer Control

Caution:

Alway test the stone heat before placing on the client, Do not touch the metal surface, otherwise the skin may be scalded.

Setting

188

Heat

Current

188

ON
OFF

Massage Stone Heater

Microcomputer Control

Caution:

Alway test the stone heat before placing on the client, Do not touch the metal surface, otherwise the skin may be scalded.



Hòt Stone Massage

64Pcs Deluxe Full Body Massage Stone Set







TECHNOGYM

RECLINE·XT

TECHNOGYM-Gambettola-ITALY-Tel. (0)547-56047

LIVELLO DIFF.
TEMPO
ETÀ
PESO
BATT. CARD.
CPR - Pulsazioni Costanti

ISTRUZIONI

1) SCEGLI UNA FUNZIONE

TEST
- Imposta l'età.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".
- Imposta il peso.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".

CPR PULSAZ. COSTANTI
- Imposta l'età.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".
- Imposta il peso.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".
- Imposta il battito cardiaco.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".
- Imposta il tempo.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".

ALLENAMENTO MANUALE
- Imposta il peso.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".
- Imposta il livello difficoltà.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".
- Imposta il tempo.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".

PERCORSI 6-12-24 MINUTI
- Scegli uno dei tre percorsi.
- Imposta il peso.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".
- Imposta il livello difficoltà.
- Premi "ENTER" o "CLEAR".

2) INIZIA L'ESERCIZIO

- Mantieni una velocità di 70-80 RPM.
- Con il tasto "+" e "-" puoi variare il livello difficoltà durante l'esercizio.

AVVERTENZE: Assicurarsi che il proprio stato fisico sia idoneo previa visita medica. In caso di malessere interrompere immediatamente l'allenamento.

TABELLA SCELTA BATTITO CARDIACO IDEALE

BATTITO CARDIACO MAX. (100%)=220-ETÀ

ETÀ	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
100%	203	198	193	188	183	178	173	168	163	158	153	148	143
80%	162	158	154	150	146	142	138	134	130	126	122	118	114
70%	142	139	135	131	128	124	121	117	114	110	107	103	100

BATTITI CARDIACI

- allenamento troppo intenso (anaerobico)
- allenamento cardio-respiratorio per sportivi
- allenamento per dimagrimento
- allenamento insufficiente

POTENZA
Watt

BATT. CARDIACO
Pulsazioni / min.

DISTANZA
Km metri x 10

TEMPO
Minuti Secondi

LAVORO
K.calorie totali

VELOCITÀ
RPM pedal. / min.

LIVELLO DIFFICOLTÀ
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

FUNZIONI
TEST
CPR PULS. COSTANTI
ALLEN. MANUALE
6 minuti
12 minuti
24 minuti

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
CLEAR
ENTER
DISPLAY MODE

CPR


CENTRO
Sorbone




TECHNOGYM


ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE


TECHNOGYM
ADDUCTOR
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50


TECHNOGYM
TECHNOGYM






ELEITRO